

AVANOS

**Sprzęt do żywienia
dojelitowego**

**Katalog
2026**

Ten katalog zawiera informacje dotyczące wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



NIEZAWODNY. ŁATWY W UŻYCIU. SKONCENTROWANY NA POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA.

AVANOS – ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Jako członek GEDSA firma Avanos dąży do zachowania zgodności z systemem ENFit® norma (ISO 80369-3).

Avanos Medical, światowy lider w dziedzinie żywienia dojelitowego, oferuje szeroki wybór, innowacyjnych zgłębników i akcesoriów wysokiej jakości, przeznaczonych do podawania pożywienia i leków zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym.

Firma Avanos jako pierwsza opracowała zgłębnik gastrostomijny mocowany przy użyciu balonika. Nasze produkty odznaczają się wysoką jakością i zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pacjentom bezpieczeństwa i wygody. Dzięki wykwalifikowanym specjalistom do spraw sprzedaży i obsługi klienta jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie na najwyższym poziomie wszystkim produktom dostępnym w naszej ofercie. Obecnie zgłębniki do żywienia dojelitowego spod znaku MIC*/MIC-KEY*/CORFLO* są powszechnie znane wśród pracowników służby zdrowia i stosowane podczas krótkoterminowego, średnioterminowego oraz długoterminowego żywienia dojelitowego.

Szeroki wybór zgłębników do żywienia dojelitowego oraz akcesoriów Avanos ułatwia indywidualny dobór właściwych produktów.

SPIS TREŚCI

1. ZESTAW WPROWADZAJĄCY DO ZGŁĘBNIKÓW BALONOWYCH: GASTROSTOMIJNYCH (G), JELITOWYCH (J), GASTROSTOMIJNO-JELITOWYCH (GJ)	4
- Zestaw wprowadzający do zgłębników gastrostomijnych (G)	5
- Zestaw wprowadzający do zgłębników jelitowych (J), gastrostomijno-jelitowych (GJ)	6
2. ZESTAWY DO PIERWOTNEJ GASTROSTOMII ENDOSKOPOWEJ (PEG)	7
3. ZGŁĘBNIKI GASTROSTOMIJNE	8
- Zgłębniki balonowe, gastrostomijne (G)	10
4. ZGŁĘBNIKI JELITOWE	
- Zgłębniki balonowe, jelitowe (J)	13
5. ZGŁĘBNIKI GASTROSTOMIJNO-JELITOWE	
- Zgłębnik balonowy, gastrostomijno-jelitowy (GJ)	15
6. ZGŁĘBNIKI NOSOWO-ŻOŁĄDKOWE (NG) / NOSOWO-JELITOWE (NI)	19
7. AKCESORIA I DODATKI	
- Zestaw wprowadzający	21
- Akcesoria do PEG	22
- Akcesoria do zgłębników niskoprofilowych	23
- Urządzenie do pomiaru stomii	23
- CORGRIP - system mocowania zgłębników	24
- CORGRIP*SR - system mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych / jelitowych (ng/ni)	25
- ANCORIS* - system mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych / jelitowych (ng/ni)	26
- System Farrell	27
- Strzykawki	27


Jako członek GEDSA firma Avanos dąży do zachowania zgodności z systemem ENFit® norma (ISO 80369-3) zawsze, gdy to możliwe.

Zwróć uwagę, że waga zgłębników nosowo-żołądkowych podana w niniejszym dokumencie jest wagą przybliżoną.

Rekomendacja rozmiaru dla pacjenta jest jedynie sugestią. W każdym przypadku należy przeprowadzić konsultację kliniczną.

ZESTAW WPROWADZAJĄCY DO ZGŁĘBNIKÓW BALONOWYCH: GASTROSTOMIJNYCH (G), JELITOWYCH (J), GASTROSTOMIJNO-JELITOWYCH (GJ)

GASTROPEKSJA, INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE KLINICZNE - MNIEJSZY URAZ, WIĘKSZY KOMFORT PACJENTA

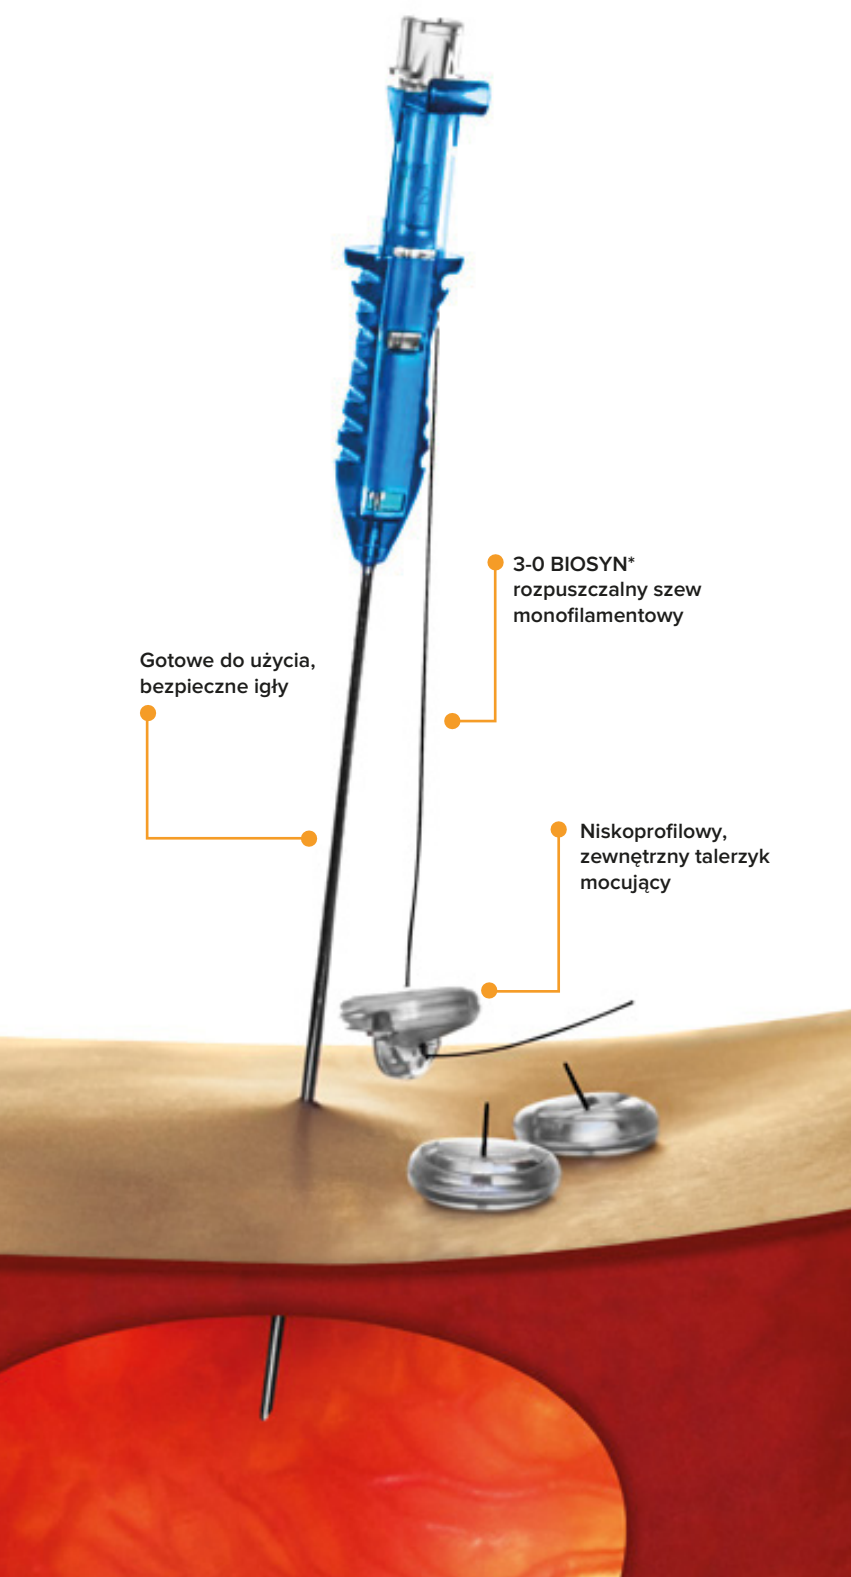

- narzędzia gwarantujące wizualną i chirurgiczną precyzję: ostro zakończony, bezpieczny zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego, skalpel oraz igła wprowadzająca,
- kontrolowane wprowadzanie,
- gotowe do użycia igły chroniące lekarza przed przypadkowym ukłuciem.


ZESTAW KOTWICZĄCY - STAF-T-PAXY

- proste, intuicyjne szwy kotwiczące,
- bezpieczne mocowanie żołądka,
- słyszalne potwierdzenie zablokowania szwu,
- możliwość regulacji blokady,
- rozpuszczalne szwy,
- sprzyja utrzymaniu higieny dzięki łatwym w czyszczeniu krążkom mocującym,

ROZSZERZACZ TELESKOPOWY

- umożliwia zastosowanie techniki Seldingera, ograniczając konieczność wielokrotnego przesuwania rozszerzacza po przewodniku,
- uzyskanie porządanego rozszerzenia przy pomocy jednego teleskopowego instrumentu,
- zintegrowany, rozrywalny płaszcz ułatwiający wprowadzanie zgłębnika,
- przeznaczony do zgłębników MIC* oraz MIC-KEY* (G,GJ) w rozmiarach od 12 Fr do 20 Fr.

ZESTAW WPROWADZAJĄCY DO ZGŁĘBNIKÓW GASTROSTOMIJNYCH (G)

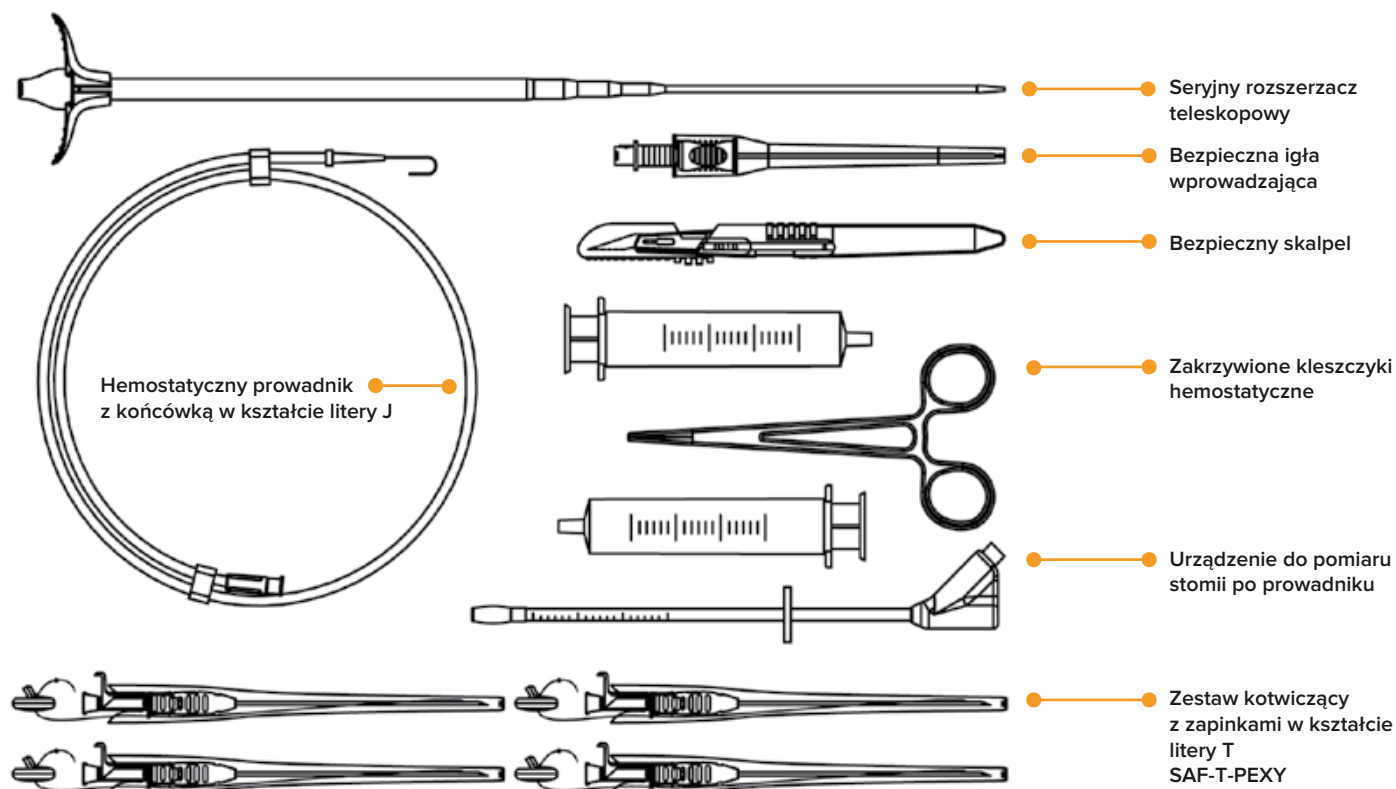

Zestaw zawiera:


- gotowy do użycia zestaw kotwiczący z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 Biosyn* oraz poliuretanową blokadą szwu,
- zakrzywione kleszczyki hemostatyczne,
- rozszerzacz seryjny,
- bezpieczny skalpel,
- bezpieczna igła wprowadzająca,
- przewód z końcówką w kształcie litery J,
- urządzenie do pomiaru stomii umożliwiające dokładny pomiar długości przetoki w celu wprowadzenia niskoprofilowego zgłębnika,
- seryjny rozszerzacz teleskopowy ze zintegrowanym rozrywalnym płaszczem strzykawki (Luer Slip).

*zestaw nie zawiera zgłębnika

Zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych MIC* lub MIC-KEY*, wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu		
Endoskopowa/ Fluoroskopowa	Laparoskopowa	Opis produktu
98430	10250	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 16 Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 12 Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 12 Fr)
98431	10230	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 18 Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 14 Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 14 Fr)
98432	10240	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 20 Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 16 Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 16 Fr)
98433	10237	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 22 Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 18 Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 18 Fr)
98434	10226	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 24 Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 20 Fr oraz zgłębnikami typu G MIC-KEY* 20 Fr)

ZESTAW WPROWADZAJĄCY DO ZGŁĘBNIKÓW JELITOWYCH (J), GASTROSTOMIJNO-JELITOWYCH (GJ)

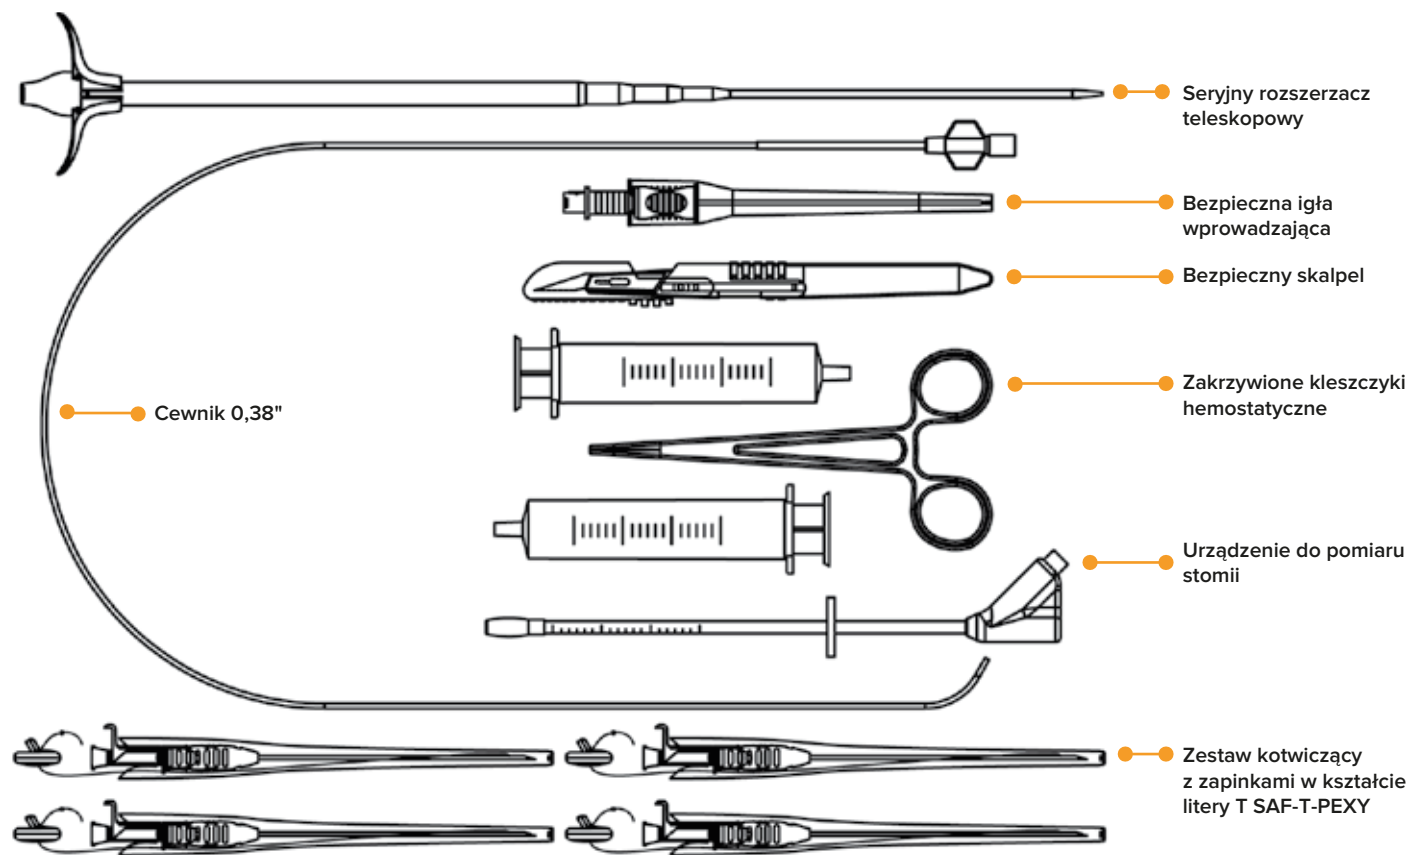

Zestaw zawiera:

- gotowy do użycia zestaw kotwiczący z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 Biosyn* oraz poliuretanową blokadą szwu,
- zakrzywione kleszczyki hemostatyczne,
- rozszerzacz seryjny,
- bezpieczny skalpel,
- bezpieczna igła wprowadzająca,
- cewnik 0,38",
- urządzenie do pomiaru stomii umożliwiające dokładny pomiar długości przetoki w celu wprowadzenia niskoprofilowego zgłębnika,
- seryjny rozszerzacz teleskopowy ze zintegrowanym, rozrywalnym płaszczem,
- strzykawki (Luer Slip).

*zestaw nie zawiera zgłębnika

Zestaw wprowadzający do wprowadzania zgłębników jelitowych i żołądkowo-jelitowych MIC* lub MIC-KEY*

Wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
98437	20 Fr, Zestaw do wprowadzania zgłębników typu MIC* J, GJ, MIC-KEY* J, GJ w rozmiarach 16 Fr	1 szt./op.
98438	22 Fr, Zestaw do wprowadzania zgłębników typu MIC* J, GJ, MIC-KEY* J, GJ w rozmiarach 18 Fr	1 szt./op.

Dobierz akcesoria - str. 21

ZESTAWY DO PIERWOTNEJ GASTROSTOMII ENDOSKOPOWEJ (PEG)

PEG CORFLO* - WERSJA PUSH I WERSJA PULL

Zestawy do PEG MAX CORFLO* są dostępne zarówno w wersji PULL, jak i PUSH (po przewodniku; OTW).

- adapter do podawania pożywienia, leków i wody zgodny z systemem ENFit®,
- jedyny w swoim rodzaju wewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z poliuretanowej pianki, który zapada się podczas wkładania i wyjmowania zgłębnika,
- zgłębnik wykonany z poliuretanu,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich,
- zacisk,
- dwa rodzaje zewnętrznego talerzyka mocującego,



Obraz przedstawia zestaw CORFLO do PEG 50-60xxx

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
50-6012E1	Zestaw CORFLO* PEG 12 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-6016E1	Zestaw CORFLO* PEG 16 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-6020E1	Zestaw CORFLO* PEG 20 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-4016E1	Zestaw CORFLO* PEG Over the Wire 16 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-4020E1	Zestaw CORFLO* PEG Over the Wire 20 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.

*możliwość zamówienia na sztuki

Dobierz akcesoria - str. 22

ZGŁĘBNIKI GASTROSTOMIJNE

PEG MIC* - WERSJA PUSH I WERSJA PULL

Zewnętrzny talerzyk mocujący zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza wokół stomii - SECUR-LOK*

Port do podawania żywienia / leków

Port do podawania żywienia / leków

Zacisk

Wewnętrzny talerzyk mocujący

- wykonany z silikonu medycznego,
- porty do podawania żywienia, leków lub wody zgodne z systemem ENFit®,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- centymetrowa podziałka,
- zgłębnik usuwany za pomocą trakcji, wyposażony w wewnętrzny, zapadający się talerzyk mocujący,
- zestaw zawiera zacisk,
- rozmiary: 14 Fr, 20 Fr, 24 Fr.

Zestaw do PEG MIC* (PULL) Basic ze złączami ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie
8644-14	Basic PULL PEG KIT	14 Fr	1 szt./op.
8644-20	Basic PULL PEG KIT	20 Fr	1 szt./op.
8644-24	Basic PULL PEG KIT	24 Fr	1 szt./op.

Zestaw do PEG 8644-xx Basic PULL zawiera:

- 1 zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji,
- 1 uniwersalny adapter do podawania pożywienia 8135-xx ze złączem ENFit®,
- 1 zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- 1 jednorazowy skalpel z ostrzem #11,
- 1 igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm,
- 1 prowadnik z pętlą,
- 1 zacisk zgłębnika,
- 1 instrukcja obsługi.

Zestaw do PEG MIC* (PULL) ze złączami ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie
9640-14	PULL	14 Fr	1 szt./op.
9640-20	PULL	20 Fr	1 szt./op.
9640-24	PULL	24 Fr	1 szt./op.

Zestaw do PEG MIC* (PUSH - OTW) ze złączami ENFit®


Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie
8630-14	PUSH (Over-The-Wire)	14 Fr	1 szt./op.
8630-20	PUSH (Over-The-Wire)	20 Fr	1 szt./op.
8630-24	PUSH (Over-The-Wire)	24 Fr	1 szt./op.

Zestaw do PEG Deluxe 9640-xx PULL zawiera:

- 1 zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą traktacji,
- 1 pętla do przeciągania 5 Fr (1,8 mm x 260 cm),
- 1 uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx,
- 1 zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- 1 igła z filtrem 22 ga x 1,5", 3,81 cm,
- 1 igła z filtrem 19 ga x 3,81 cm,
- 1 igła 25 ga x 1,5875 cm
- 1 serweta z wycięciem z podkładkami samoprzylepnymi,
- 1 strzykawka 12 ml,
- 1 jednorazowy skalpel z ostrzem #11,
- 1 igła wprowadzająca 14 ga x 6,985 cm,
- 1 przewódnik z pętlą,
- 1 zacisk zgłębnika,
- 4 gaziki 10,16 cm x 10,16 cm,
- 2 gaziki z nacięciem 5,08 cm x 5,08 cm,
- 1 nić chirurgiczna,
- 1 instrukcja obsługi.

Zestaw do PEG Deluxe 8630-xx PUSH zawiera:

- 1 zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą traktacji,
- 1 pętla do przeciągania 5 Fr (1,8 mm x 260 cm),
- 1 uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx,
- 1 zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- 1 igła z filtrem 22 ga x 1,5", 3,81 cm,
- 1 igła 25 ga x 1,5875 cm,
- 1 igła 25 ga x 1,5875 cm,
- 1 serweta z wycięciem z podkładkami samoprzylepnymi,
- 1 strzykawka 12 ml,
- 1 jednorazowy skalpel z ostrzem #11,
- 1 igła wprowadzająca 14 ga x 6,985 cm,
- 1 przewódnik (0,038" x 260 cm),
- 1 zacisk zgłębnika,
- 4 gaziki 10,16 cm x 10,16 cm,
- 2 gaziki z nacięciem 5,08 cm x 5,08 cm,
- 1 nić chirurgiczna,
- 1 instrukcja obsługi.

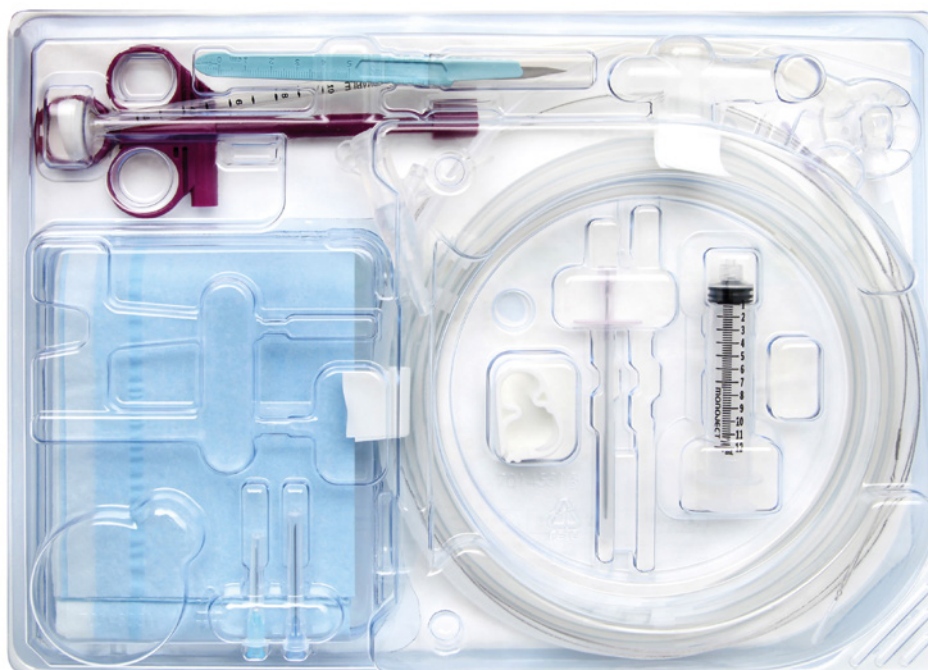

Obraz przedstawia zestaw do PEG Deluxe PULL 9640-xx

ZGŁĘBNIKI BALONOWE, GASTROSTOMIJNE (G)

MIC*G

- zgodny z systemem ENFit®,
- wykonany z silikonu medycznego,
- biały port balonika, oznaczony jako "Bal.", służący do napełniania i opróżniania balonika mocującego po umieszczeniu go w żołądku pacjenta,
- zalecana średnica i objętość balonika nadrukowane na porcie Bal.,
- centymetrowa podziałka,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich na całej długości zgłębnika,
- wewnętrzny, silikonowy balonik mocujący,
- dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku,
- dostępny w wersji jedno i dwu portowej.



Jednoportowy zgłębnik gastostomijny MIC* ze złączem ENFit®

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8110-12LV	12 Fr	2-3 ml	1 szt./op.
8110-14LV	14 Fr	3-5 ml	1 szt./op.
8110-16LV	16 Fr	3-5 ml	1 szt./op.
8110-18	18 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8110-20	20 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8110-22	22 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8110-24	24 Fr	7-10 ml	1 szt./op.



Dwuportowy zgłębnik gastostomijny MIC* ze złączem ENFit®

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8100-12LV	12 Fr	2-3 ml	1 szt./op.
8100-14LV	14 Fr	3-5 ml	1 szt./op.
8100-16LV	16 Fr	3-5 ml	1 szt./op.
8100-18	18 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8100-20	20 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8100-22	22 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8100-24	24 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8100-26	26 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8100-28	28 Fr	7-10 ml	1 szt./op.
8100-30	30 Fr	7-10 ml	1 szt./op.

MIC-KEY*G (NISKOPROFILOWY) - ZESTAW

- wykonany z silikonu medycznego,
- niskoprofilowa konstrukcja,
- stożkowa końcówka dystalna,
- wewnętrzny, silikonowy balonik mocujący,
- dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku,
- zawór antyrefluksowy,
- mechanizm złącza zestawu przedłużającego ENFit® SECUR-LOK*,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich,
- rozmiary od 12-20 Fr i długości od 0,8-5 cm.



Zestaw zawiera:

- 1 zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY*,
- 1 zestaw przedłużający do żywienia ciągłego MIC-KEY* ze złączem ENFit®, o długości 30 cm, ze złączem kątowym SECUR-LOK* i portami do podawania żywienia i leków,
- 1 bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, z prostym złączem SECUR-LOK* z portami do podawania żywienia i leków,
- 1 strzykawka 6 ml (Luer Slip przeznaczona do napełniania/ opróżniania balonika retencyjnego),
- 1 strzykawka 35 ml do podawania preparatów żywieniowych ze złączem ENFit®,
- 4 gaziki.

Zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY* ze złączami ENFit® - dobierz akcesoria - str. 23

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8140-12-0.8	12 Fr	0,8 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-1.0	12 Fr	1,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-1.2	12 Fr	1,2 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-1.5	12 Fr	1,5 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-1.7	12 Fr	1,7 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-2.0	12 Fr	2,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-2.3	12 Fr	2,3 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-2.5	12 Fr	2,5 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-2.7	12 Fr	2,7 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-3.0	12 Fr	3,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-3.5	12 Fr	3,5 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-12-4.0	12 Fr	4,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-14-0.8	14 Fr	0,8 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-1.0	14 Fr	1,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-1.2	14 Fr	1,2 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-1.5	14 Fr	1,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-1.7	14 Fr	1,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-2.0	14 Fr	2,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-2.3	14 Fr	2,3 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-2.5	14 Fr	2,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-2.7	14 Fr	2,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-3.0	14 Fr	3,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-3.5	14 Fr	3,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-4.0	14 Fr	4,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-4.5	14 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-14-5.0	14 Fr	5,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-16-0.8	16 Fr	0,8 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-1.0	16 Fr	1,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-1.2	16 Fr	1,2 cm	3 ml	1 szt./op.

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8140-16-1.5	16 Fr	1,5 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-1.7	16 Fr	1,7 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-2.0	16 Fr	2,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-2.3	16 Fr	2,3 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-2.5	16 Fr	2,5 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-2.7	16 Fr	2,7 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-3.0	16 Fr	3,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-3.5	16 Fr	3,5 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-4.0	16 Fr	4,0 cm	3 ml	1 szt./op.
8140-16-4.5	16 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-16-5.0	16 Fr	5,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-0.8	18 Fr	0,8 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-1.0	18 Fr	1,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-1.2	18 Fr	1,2 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-1.5	18 Fr	1,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-1.7	18 Fr	1,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-2.0	18 Fr	2,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-2.3	18 Fr	2,3 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-2.5	18 Fr	2,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-2.7	18 Fr	2,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-3.0	18 Fr	3,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-3.5	18 Fr	3,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-4.0	18 Fr	4,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-4.5	18 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-18-5.0	18 Fr	5,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-0.8	20 Fr	0,8 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-1.0	20 Fr	1,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-1.2	20 Fr	1,2 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-1.5	20 Fr	1,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-1.7	20 Fr	1,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-2.0	20 Fr	2,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-2.3	20 Fr	2,3 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-2.5	20 Fr	2,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-2.7	20 Fr	2,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-3.0	20 Fr	3,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-3.5	20 Fr	3,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-4.0	20 Fr	4,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-4.5	20 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-20-5.0	20 Fr	5,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-1.5	24 Fr	1,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-1.7	24 Fr	1,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-2.0	24 Fr	2,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-2.3	24 Fr	2,3 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-2.5	24 Fr	2,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-2.7	24 Fr	2,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-3.0	24 Fr	3,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-3.5	24 Fr	3,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-4.0	24 Fr	4,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-4.5	24 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8140-24-5.0	24 Fr	5,0 cm	5 ml	1 szt./op.

Dobierz akcesoria - str. 23


ZGŁĘBNIKI JELITOWE

ZGŁĘBNIKI BALONOWE, JELITOWE (J)

MIC* J (TUBE)

ZGŁĘBNIK WPROWADZANY METODĄ OPERACYJNĄ (ENDOSKOPOWĄ / RADIOLOGICZNĄ)

- wykonany z silikonu medycznego,
- pojedynczy port dostępu jelitowego ze złączem ENFit[®],
- biały port, oznaczony jako Bal., służący do napełniania / opróżniania balonika mocującego,
- oznaczenie średnicy przetoki nadrukowane na porcie Bal.,
- oznaczenia w centymetrach,
- zewnętrzny pierścień mocujący SECUR-LOK^{*},
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich na całej długości zgłębnika,
- możliwość przycięcia końcówki dystalnej, aby dostosować zgłębnik do potrzeb poszczególnych pacjentów,
- dostępny w rozmiarach 12-24 Fr.

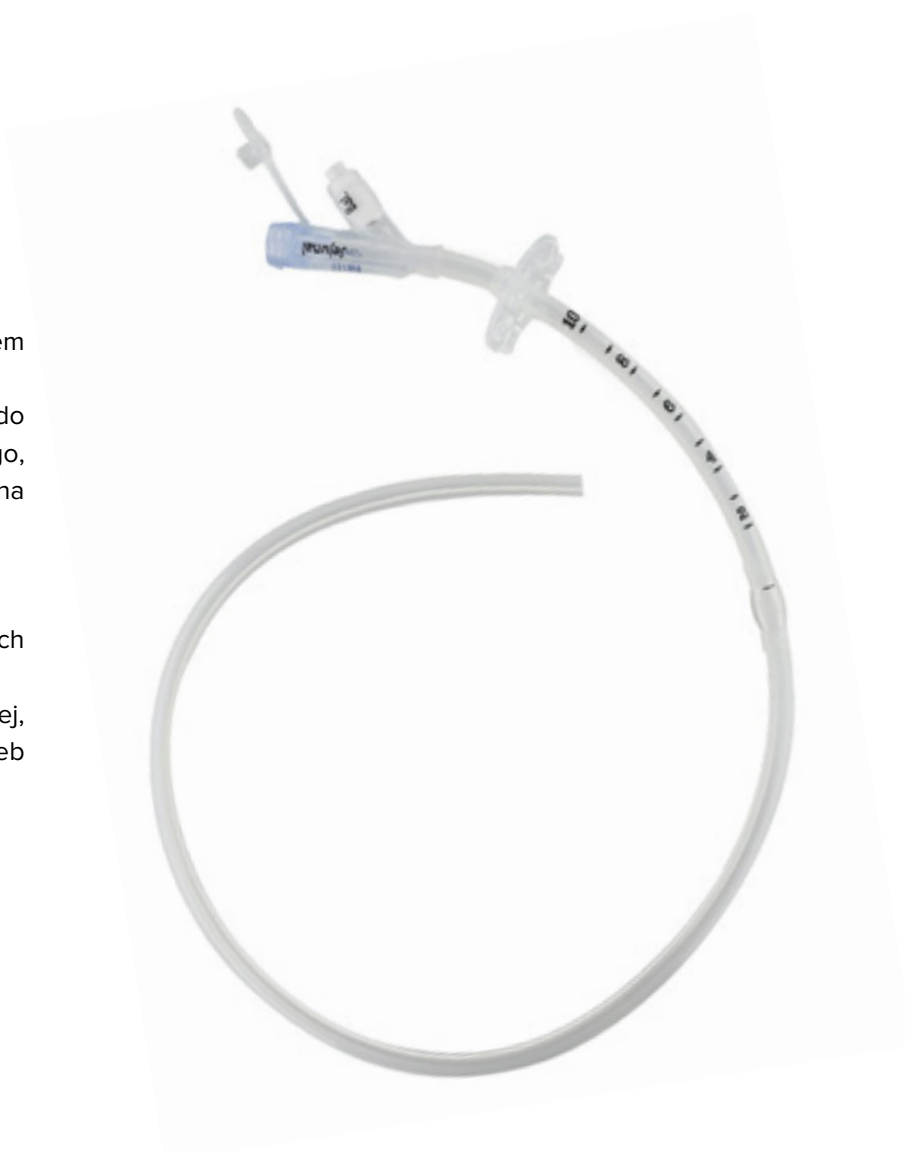

Zgłębnik jelitowy MIC* ze złączami ENFit[®]

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie*
8200-12LV	12 Fr	2-3 ml	2 szt./op.
8200-14	14 Fr	7-10 ml	2 szt./op.
8200-16	16 Fr	7-10 ml	2 szt./op.
8200-18	18 Fr	7-10 ml	2 szt./op.
8200-20	20 Fr	7-10 ml	2 szt./op.
8200-22	22 Fr	7-10 ml	2 szt./op.
8200-24	24 Fr	7-10 ml	2 szt./op.

Długość części jelitowej zgłębnika MIC* J należy mierzyć od dalszego końca balonika mocującego do końcówki zgłębnika. Standardowa długość zgłębnika wynosi 51 cm, niemniej jednak istnieje możliwość przycięcia, aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentów.

*możliwość zamówienia na sztuki

MIC-KEY (NISKOPROFILOWY) - ZESTAW

Zestaw zawiera:

- 1 zgłębnik typu J MIC-KEY*,
- 1 kaniula wprowadzająca,
- 1 zestaw przedłużający do żywienia ciągłego MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, ze złączem kątowym, SECUR-LOK® i portami do podawania żywienia i leków
- 1 bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, z prostym złączem SECUR-LOK® z portem do podawania żywienia / leków,
- 1 strzykawka 6 ml (Luer Slip) służąca do napełniania/ opróżniania balonika retencyjnego,
- 4 gaziki.



Zgłębnik jelitowy MIC-KEY* J, ENFit (NISKOPROFILOWY) - dobierz akcesoria - str. 23

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8230-14-0.8	14 Fr	0,8 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-1.0	14 Fr	1,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-1.2	14 Fr	1,2 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-1.5	14 Fr	1,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-1.7	14 Fr	1,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-2.0	14 Fr	2,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-2.3	14 Fr	2,3 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-2.5	14 Fr	2,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-2.7	14 Fr	2,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-3.0	14 Fr	3,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-3.5	14 Fr	3,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-4.0	14 Fr	4,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-14-4.5	14 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-0.8	18 Fr	0,8 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-1.0	18 Fr	1,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-1.2	18 Fr	1,2 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-1.5	18 Fr	1,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-1.7	18 Fr	1,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-2.0	18 Fr	2,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-2.3	18 Fr	2,3 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-2.5	18 Fr	2,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-2.7	18 Fr	2,7 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-3.0	18 Fr	3,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-3.5	18 Fr	3,5 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-4.0	18 Fr	4,0 cm	5 ml	1 szt./op.
8230-18-4.5	18 Fr	4,5 cm	5 ml	1 szt./op.

*Długość części jelitowej zgłębnika MIC-KEY J należy mierzyć od dalszego końca balonika mocującego do końca zgłębnika.

Dobierz akcesoria - str. 23

ZGŁĘBNIKI GASTROSTOMIJNO-JELITOWE

ZGŁĘBNIK BALONOWY, GASTROSTOMIJNO-JELITOWY

MIC*GJ (TUBE)

WPROWADZANY METODĄ ENDOSKOPOWĄ / RADIOLOGICZNĄ

- wykonany z silikonu medycznego,
- wbudowany silikonowy balonik zabezpieczający (7-10 ml), zgłębniki o długości części jelitowej wynoszącej 25,4 cm posiadają balonik 3-5 ml,
- zewnętrzny pierścień mocujący SECUR-LOK*,
- część jelitowa zgłębnika zakończona obciążnikiem z wolframu,
- dwa porty ze złączem ENFit® przeznaczone do podawania żywienia oraz dekompresji lub odbarczania żołądka,
- znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim,
- wysterylizowany promieniami gamma,
- wykonany z silikonu medycznego,
- porty dostępu z oddzielnymi oznaczeniami:
 - a) Gastric - ze złączem ENFit® (do dekompresji/odbarczania żołądka),
 - b) Jejunal - ze złączem ENFit®,
 - c) Bal. - służy do napełniania / opróżniania balonika mocującego,
- oznaczenie średnicy zgłębnika GJ nadrukowane na porcie balonika,
- oznaczenia w centymetrach,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- wewnętrzny, silikonowy balonik retencyjny,
- zgłębnik obciążony wolframem w części jelitowej w celu unieruchomienia zgłębnika za zwieraczem odźwiernika, dystalne otwory wylotowe nad końcówką zgłębnika oraz
- na samej końcówce wspomagające przepływ i eliminujące ryzyko zapchania, stożkowa końcówka oraz szew pętlowy ułatwiający wprowadzanie zgłębnika przez odźwiernik.



Zgłębniki żołądkowo-jelitowe AVANOS* MIC

Rozmiar (śr. zewn.)	25,4 cm	57,9 cm
16 Fr	8210-16LV	8210-16
18 Fr	8210-18LV	8210-18
20 Fr		8210-20
22 Fr		8210-22
24 Fr		8210-24
26 Fr		8210-26
28 Fr		8210-28
30 Fr		8210-30



Zestaw endo/radio zawiera:

- 1 zgłębnik żołądkowo-jelitowy,
- 1 silikonowy przewódnik,
- 1 strzykawka ENFit® 35 ml.

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ ze złączami ENFit®, wprowadzany metodą endoskopową / radiologiczną

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8650-16-15	16 Fr	15 cm	5 ml	1 szt./op.
8650-16-22	16 Fr	22 cm	5 ml	1 szt./op.
8650-16-30	16 Fr	30 cm	5 ml	1 szt./op.
8650-16	16 Fr	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8650-18-22	18 Fr	22 cm	5 ml	1 szt./op.
8650-18-30	18 Fr	30 cm	5 ml	1 szt./op.
8650-18	18 Fr	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8650-22	22 Fr	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.

*Długość części jelitowej należy mierzyć od dalszego końca balonika mocującego do końca cewnika.

WPROWADZANY METODĄ OPERACYJNĄ



Zestaw zawiera:

- 1 zgłębnik żołądkowo-jelitowy,
- 1 trokar brzuszny z płaszczem,
- 1 kaniula transpyloryczna,
- 1 strzykawka ENFit® 35 ml.


Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC* ze złączami ENFit® - wprowadzany metodą operacyjną

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość części jelitowej	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8660-16	16 Fr	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8660-18	18 Fr	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8660-22	22 Fr	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.

*Długość części jelitowej należy mierzyć od dystalnego końca balonika mocującego do końca rurki.

MIC-KEY*GJ (NISKOPROFILOWY)

- oznaczone, oddzielne porty; port żołądkowy i port jelitowy, zgodne z systemem ENFit® umożliwiające podawanie żywienia oraz jednoczesną dekompresję żołądka,
- liczne porty wyjściowe do podawania żywienia, wspomagające przepływ i zmniejszające prawdopodobieństwo zapchania,
- wbudowany port jelitowy ułatwiający wprowadzanie po przewodniku,
- stożkowa końcówka dystalna umożliwiając atraumatyczne wprowadzanie zgłębnika,
- liczne wyjściowe porty do podawania żywienia,
- niskoprofilowa konstrukcja,
- wewnętrzny balonik mocujący,
- wykonany z silikonu medycznego,
- część jelitowa obciążona wolframem,
- kompatybilny z zestawami przedłużającymi MIC-KEY*.

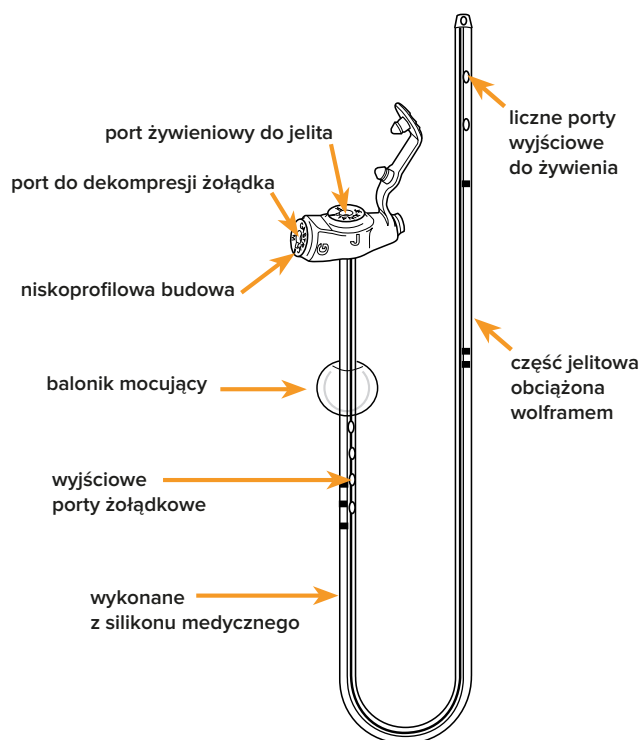

Zestaw zawiera:

- 1 zgłębnik typu GJ MIC-KEY*,
- 1 kaniula wprowadzająca,
- 1 zestaw przedłużający do ciągłego żywienia MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, ze złączem kątowym SECUR-LOK* z zatyczkami i portami do podawania pożywienia i leków,
- 1 bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, z prostym złączem SECUR-LOK* z portem do podawania żywienia / leków,
- 1 urządzenie do pomiaru stomii,
- 1 strzykawka (Luer Slip) 6 ml służąca do napełniania / opróżniania balonika mocującego,
- 4 gaziki.

Dobierz akcesoria - str. 23


Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Długość części jelitowej	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8270-14-1.0-15	14 Fr	1,0 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.0-22	14 Fr	1,0 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.2-15	14 Fr	1,2 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.2-22	14 Fr	1,2 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.2-30	14 Fr	1,2 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.5-15	14 Fr	1,5 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.5-22	14 Fr	1,5 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.5-30	14 Fr	1,5 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.5-45	14 Fr	1,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-1.7-15	14 Fr	1,7 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.7-22	14 Fr	1,7 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.7-30	14 Fr	1,7 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-1.7-45	14 Fr	1,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-2.0-22	14 Fr	2,0 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-2.0-30	14 Fr	2,0 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-2.0-45	14 Fr	2,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-2.3-30	14 Fr	2,3 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-2.3-45	14 Fr	2,3 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-2.5-30	14 Fr	2,5 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-2.5-45	14 Fr	2,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-2.7-30	14 Fr	2,7 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-14-2.7-45	14 Fr	2,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-3.0-45	14 Fr	3,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-3.5-45	14 Fr	3,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-4.0-45	14 Fr	4,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-4.5-45	14 Fr	4,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-5.0-45	14 Fr	5,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-5.5-45	14 Fr	5,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-6.0-45	14 Fr	6,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-6.5-45	14 Fr	6,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-14-7.0-45	14 Fr	7,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-1.0-15	16 Fr	1,0 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.0-22	16 Fr	1,0 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.2-15	16 Fr	1,2 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.2-22	16 Fr	1,2 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.2-30	16 Fr	1,2 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.5-15	16 Fr	1,5 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.5-22	16 Fr	1,5 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.5-30	16 Fr	1,5 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.5-45	16 Fr	1,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-1.7-15	16 Fr	1,7 cm	15 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.7-22	16 Fr	1,7 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.7-30	16 Fr	1,7 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-1.7-45	16 Fr	1,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-2.0-22	16 Fr	2,0 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-2.0-30	16 Fr	2,0 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-2.0-45	16 Fr	2,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-2.3-30	16 Fr	2,3 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-2.3-45	16 Fr	2,3 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-2.5-30	16 Fr	2,5 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-2.5-45	16 Fr	2,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-2.7-30	16 Fr	2,7 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-16-2.7-45	16 Fr	2,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-3.0-45	16 Fr	3,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-3.5-45	16 Fr	3,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Długość części jelitowej	Zalecane wypełnienie balonika	Opakowanie
8270-16-4.0-45	16 Fr	4,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-4.5-45	16 Fr	4,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-5.0-45	16 Fr	5,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-5.5-45	16 Fr	5,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-6.0-45	16 Fr	6,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-6.5-45	16 Fr	6,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-16-7.0-45	16 Fr	7,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-1.2-22	18 Fr	1,2 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-1.2-30	18 Fr	1,2 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-1.5-22	18 Fr	1,5 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-1.5-30	18 Fr	1,5 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-1.5-45	18 Fr	1,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-1.7-22	18 Fr	1,7 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-1.7-30	18 Fr	1,7 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-1.7-45	18 Fr	1,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-2.0-22	18 Fr	2,0 cm	22 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-2.0-30	18 Fr	2,0 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-2.0-45	18 Fr	2,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-2.3-30	18 Fr	2,3 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-2.3-45	18 Fr	2,3 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-2.5-30	18 Fr	2,5 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-2.5-45	18 Fr	2,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-2.7-30	18 Fr	2,7 cm	30 cm	3-5 ml	1 szt./op.
8270-18-2.7-45	18 Fr	2,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-3.0-45	18 Fr	3,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-3.5-45	18 Fr	3,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-4.0-45	18 Fr	4,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-4.5-45	18 Fr	4,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-5.0-45	18 Fr	5,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-5.5-45	18 Fr	5,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-6.0-45	18 Fr	6,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-6.5-45	18 Fr	6,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-18-7.0-45	18 Fr	7,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-1.5-45	22 Fr	1,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-1.7-45	22 Fr	1,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-2.0-45	22 Fr	2,0 cm	45 cm	7-10ml	1 szt./op.
8270-22-2.3-45	22 Fr	2,3 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-2.5-45	22 Fr	2,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-2.7-45	22 Fr	2,7 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-3.0-45	22 Fr	3,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-3.5-45	22 Fr	3,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-4.0-45	22 Fr	4,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-4.5-45	22 Fr	4,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-5.0-45	22 Fr	5,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-5.5-45	22 Fr	5,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-6.0-45	22 Fr	6,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-6.5-45	22 Fr	6,5 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.
8270-22-7.0-45	22 Fr	7,0 cm	45 cm	7-10 ml	1 szt./op.

Dobierz akcesoria - str. 23

ZGŁĘBNIKI NOSOWO-ŻOŁĄDKOWE (NG) / NOSOWO-JELITOWE (NI)

- zgodne z systemem ENFit®,
- zgłębnik wykonany z poliuretanu,
- oznaczenia długości i średnicy nadrukowane na zgłębniku,
- podwójny port umożliwiający jednoczesne karmienie, przepłukiwanie oraz / lub podawanie leków bez konieczności odłączania poszczególnych linii,
- niezapychające się zakończenie zgłębnika (ANTI-CLOG system),



- reagujący z wodą, hydrofilowy lubrykant C-19™ na końcówce oraz we wnętrzu zgłębnika,
- znacznik RTG na całej długości oraz końcówce zgłębnika,
- obciążony wolframem (1 g, 3 g lub 7 g) lub nieobciążony,
- dostępny w wersji z plecionym mandrynem ze stali nierdzewnej lub bez mandrynu,
- dostępne rozmiary od 5 Fr do 12 Fr, brak ograniczenia czasu użytkowania.

Zgłębnik należy monitorować, poddawać regularnej ocenie i wymieniać, gdy jest to konieczne. Konieczność wymiany zgłębnika stwierdza się na podstawie jego działania oraz stanu pacjenta.



CORFLO* poliuretanowy, w całości kontrastujący w RTG, znacznik co 1 cm, obciążony (3 g), z mandrynem

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
42-8226	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-7366	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-7368	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-2438	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-7558	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 140 cm	10 szt./opak.
42-7361	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 91 cm	10 szt./opak.



*możliwość zamówienia na sztuki

CORFLO* poliuretanowy, w całości kontrastujący w RTG, znacznik co 1 cm, nieobciążony, z mandrynem

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
42-9225	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 5 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-9156	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 38 cm	10 szt./opak.
42-9226	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-9366	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-9228	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-9368	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-9438	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-9558	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 140 cm	10 szt./opak.
42-9361	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-1362	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 12 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-9431	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-9551	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 140 cm	10 szt./opak.
42-9432	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 12 Fr x 109 cm	10 szt./opak.

**CORFLO* poliuretanowy, w całości kontrastujący w RTG, znacznik co 1 cm, nieobciążony, bez mandrynu**

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
42-1432	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/ nosowo-jelitowy, 12 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-1226	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/ nosowo-jelitowy, zaokrąglona końcówka (Bullet Bolus Tip), 6 Fr x 56 cm	10 szt./opak.

**CORFLO* Zgłębnik nosowo-jelitowy do umieszczenia endoskopowego**

Do endoskopowego lub radiologicznego umieszczania z drutem prowadzącym (Over The Wire); zachowuje te same cechy, co standardowe zgłębniki CORFLO*.

Zgłębnik CORFLO* 152 cm, w całości kontrastujący w RTG, poliuretanowy, znacznik co 1 cm, elastyczny przewód pokryty teflonem (średnica 0,035 mm), rurka do podaży donosowej/doustnej 10 Fr, 56 cm.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
51-4602	CORFLO* Zgłębnik nosowo-jelitowy, 12 Fr, 152 cm, 7 gr obciążony	1
51-9601	CORFLO* Zgłębnik nosowo-jelitowy, 10 Fr, 152 cm, nieobciążony	1



*możliwość zamówienia na sztuki

AKCESORIA I DODATKI

ZESTAW WPROWADZAJĄCY



System rozszerzania dostępu, wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
98702	16 Fr, rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 12 Fr	1 szt./op.
98703	18 Fr, rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 14 Fr	1 szt./op.
98704	20 Fr, rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 16 Fr	1 szt./op.
98705	22 Fr, rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 18 Fr	1 szt./op.
98706	24 Fr, rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 20 Fr	1 szt./op.



Zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego ze szwami SAF-T-PEXY, wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
98701	SAF-T-PEXY* T-Fasteners, igły z kotwicami wraz z zakrzywionymi kleszczykami hemostatycznymi	1 op. zawiera 3 igły oraz 1 kleszczyki

AKCESORIA DO PEG

Porty wymienne do PEG MIC* ze złączami ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
8135-14	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 14 Fr PEG	1 szt./op.
8135-20	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 20 Fr PEG	1 szt./op.
8135-24	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 24 Fr PEG	1 szt./op.




CORFLO* PEG Zestaw naprawczy (port wymienny)

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
50-6112	CORFLO* PEG Zestaw naprawczy 12 Fr	5 szt./opak.
50-6116	CORFLO* PEG Zestaw naprawczy 16 Fr	5 szt./opak.
50-6120	CORFLO* PEG Zestaw naprawczy 20 Fr	5 szt./opak.



Kod produktu*	Opis produktu
QOSINA 40075	Port ENFit S, 8 Fr
QOSINA 40076	Port ENFit M, 10 Fr
QOSINA 40077	Port ENFit L, 12 Fr
QOSINA 40015	Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFit®, może służyć jako zamiennik każdego korka w standardzie ENFit®, kompatybilny ze zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz gastrostomijnymi, złącze oral/luer
QOSINA 13020	Klips boczny, biały, dedykowany do zgłębników typu G-Tube i pozostałych zgłębników gastrostomijnych, przeznaczony do rozmiarów 14 Fr - 22 Fr
QOSINA 14112	Klips mały, czarny, uniwersalny, przeznaczony do zgłębników w rozmiarach 6 Fr - 16 Fr
QOSINA 14084	Klips duży, niebieski, uniwersalny, posiada stopniową regulację zamknięcia, przeznaczony do zgłębników o średnicy max 34 Fr
QOSINA 40026	Transparentna nakrętka z męskim gwintem typu ENFit®, może służyć jako zamknięcie strzykawki lub linii podaży dojelitowej



*możliwość zamówienia na sztuki

AKCESORIA DO ZGŁĘBNIKÓW NISKOPROFILOWYCH

- mechanizm złącza SECUR-LOK*,
- port umożliwiający podawanie preparatu żywieniowego, leków oraz wody,
- zacisk zgłębnika,
- pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu,
- złącza ENFit®.



0141-24 Y Port



0142-02



0143-12 Bolus



0144-12 Bolus

Zestaw przedłużający MIC-KEY* do niskoprofilowych zgłębników, ze złączami ENFit®, niesterylny

Kod produktu	Opis produktu	Długość	Opakowanie*
0142-02	Zestawy przedłużające do zgłębników MIC-KEY* do podawania leków – ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i 2 portami typu "Y" ENFit®	5 cm	5 szt./op.
0141-12	Zestaw przedłużający MIC-KEY* do żywienia ciągłego ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i z 2 portami typu "Y" ENFit® oraz zaciskiem	30 cm	5 szt./op.
0141-24	Zestaw przedłużający MIC-KEY* do żywienia ciągłego ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i z 2 portami typu "Y" ENFit® oraz zaciskiem	60 cm	5 szt./op.
0143-12	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	30 cm	5 szt./op.
0143-24	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	60 cm	5 szt./op.
0144-12	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	30 cm	5 szt./op.
0144-24	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	60 cm	5 szt./op.

URZĄDZENIE DO POMIARU STOMII

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY* pomaga w określeniu długości stomii w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta dzięki prawidłowo dopasowanemu zgłębnikowi do żywienia dojelitowego. Podwójne światło umożliwia zastosowanie techniki Seldingera. Zestaw zawiera strzykawkę Luer Slip 12 ml służącą do napełniania/oprózniczenia balonika retencyjnego.




Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY*, wysterylizowane tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
98460	MIC-KEY* Urządzenie do pomiaru stomii	10 szt./op.

*możliwość sprzedaży na sztuki

CORGRIP -SYSTEM MOCOWANIA ZGŁĘBNIKÓW

- unikalny system wprowadzania nie wymaga przeciągania cewnika za kością lemieszową,
- specjalny klips unieruchamiający Slot Slide Lock (SSL), centymetrowa podziałka,
- do rozmiarów od 8 Fr do 18 Fr,
- biokompatybilna, trwała poliestrowa taśma mocująca,
- może być używany przez 4 tygodnie,
- w zestawie dodatkowy klips i urządzenie otwierające.

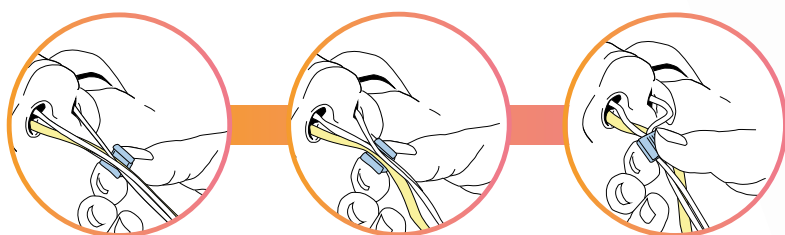

CORGRIP* System mocowania zgłębników NG/NI

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
25-008	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami I\G/Ni 8 Fr	10 szt./opak.
25-010	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/Ni 10 Fr	10 szt./opak.
25-012	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/Ni 12 Fr	10 szt./opak.
25-014	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/Ni 14 Fr	10 szt./opak.
25-016	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/Ni 16 Fr	10 szt./opak.
25-018	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/Ni 18 Fr	10 szt./opak.



*możliwość sprzedaży na sztuki

CORGRIP®SR - SYSTEM MOCOWANIA ZGŁĘBNIKÓW NOSOWO-ŻOŁĄDKOWYCH / JELITOWYCH (NG/NI)

ZGŁĘBNIK ZAWSZE NA SWOIM MIEJSCU - BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO!

System mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych/jelitowych (NG/NI) CORGRIP® SR przeznaczony do stosowania ze zgłębnikami do żywienia dojelitowego (≥ 8 Fr) oraz zgłębnikami do dekompresji, odsysania i drenażu (≤ 18 Fr). Zapobiega przypadkowemu usunięciu lub przemieszczeniu zgłębnika u dorosłych pacjentów.



Kod produktu	Opis produktu	Kolor	
26-008	8 Fr	Jasnoniebieski	
26-012	12 Fr	Biały	
26-010	10 Fr	Różowy	
26-014	14 Fr	Zółty	
26-016	16 Fr	Pomarańczowy	
26-018	18 Fr	Jasnobrązowy	

Wszystkie urządzenia medyczne wiążą się z nieodłącznym ryzykiem. Wskazania, przestrogi, ostrzeżenia i przeciwwskazania można znaleźć na etykiecie produktu i na stronie <https://eifu.avanos.com/AVA/all>. Dostępność tych produktów może się różnić w zależności od kraju lub regionu, w związku z określonymi lokalnymi wymogami dotyczącymi zatwierdzenia lub dopuszczenia do sprzedaży w danym kraju lub regionie. Dokument nie stanowi umowy. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów w celu poprawy ich jakości bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt oczekuje na zatwierdzenie 510(k) i nie jest dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Ten produkt NIE został zbadany przez FDA i NIE jest dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Przestroga: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lekarza lub na jego zlecenie.

ANCORIS* - SYSTEM MOCOWANIA ZGŁĘBNIKÓW NOSOWO-ŻOŁĄDKOWYCH / JELITOWYCH (NG/NI)

PROSTY I ESTETYCZNY SPOSÓB NA UTRZYMANIE ZGŁĘBNIKA NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU, BEZ UCIAŻLIWEJ TAŚMY

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

- zatwierdzone dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych,
- współpracują z większością dostępnych obecnie na rynku zgłębników nosowo-żołądkowych o małej średnicy,
- dostępne w rozmiarach 6, 8, 10, 12 i 14 Fr.



Zacisk dopasowany do rozmiaru zgłębnika

Warstwa pianki zapewnia amortyzację

Klej o wydłużonej trwałości

Zdejmowalna podkładka

BADANIA DOWODZĄ, ŻE 40%-60% ZGŁĘBNIKÓW NOSOWO-ŻOŁĄDKOWYCH ZABEZPIECZONYCH TAŚMĄ ULEGA PRZYPADKOWEMU PRZEMIESZCZENIU.^{1,2}

Może to prowadzić do:



Opóźnionego żywienia dojelitowego¹



Zwiększonego ryzyka aspiracji³



Niepotrzebnej ekspozycji pacjentów na promieniowanie rentgenowskie¹



Zwiększenia kosztów i czasu związanych z RTG i wymianą zgłębników¹

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
ATAS-6-NSB	6 Fr, 6,5 Fr	10 szt./op.
ATAS-8-NSB	8 Fr	10 szt./op.
ATAS-10-NSB	10 Fr	10 szt./op.
ATAS-12-NSB	12 Fr	10 szt./op.
ATAS-14-NSB	14 Fr	10 szt./op.

1. Allan K. Observation of inadvertent tube loss in ICU: effect of nasal bridles. British Journal of Nursing. 2019 Oct 10;28(18):1170-1174.

2. Parrish, C. Nasal Bridle: Married to Your Tube. Practical Gastroenterology. January 2011: 27-34.

3. Burns SM, et. al. Comparison of nasogastric tube securing methods and tube types in medical intensive care patients. Am J Crit Care. 1995 May;4(3):198-203. PMID: 7787913.

† Wyniki oceny klinicznej używanego produktu, dane z badań własnych dostępne do weryfikacji.


SYSTEM FARRELL

FARRELL* Valve System

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
44-4100	FARRELL* Valve System: System do ciągłej dekompresji żołądka - Zawór FARRELL* zapewnia kanał do ciągłej dekompresji żołądka, złącze ENFit®.	30 szt./opak.



STRZYKAWKI

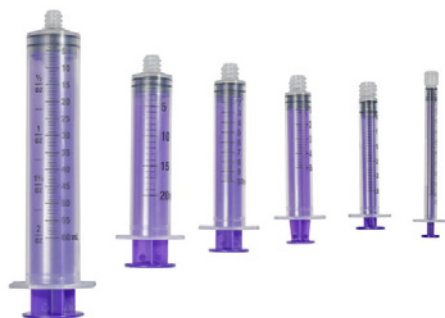

- ergonomiczny kształt,
- widoczna i wyraźna skala,
- gładkie prowadzenie tłoka,
- gwint umieszczony centrycznie,
- sterylizowane tlenkiem etylenu,
- ważne 60 msc od daty produkcji,
- pakowane pojedynczo w blister,
- dostępne w objętościach: 60 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 1 ml.

Strzykawki do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
SYR-01S	Strzykawka ENFit® 1 ml	1 szt./op.
SYR-03S	Strzykawka ENFit® 3 ml	1 szt./op.
SYR-05S	Strzykawka ENFit® 5 ml	1 szt./op.
SYR-10S	Strzykawka ENFit® 10 ml	1 szt./op.
SYR-20S	Strzykawka ENFit® 20 ml	1 szt./op.
SYR-60S	Strzykawka ENFit® 60 ml	1 szt./op.

*możliwość sprzedaży na sztuki



Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel. + 48 94 344 90 61 / 59, fax: +48 94 347 10 41
zywienie@meden.com.pl, www.meden.com.pl